GE Healthcare

# Biacore T100 Ver.2 日本語取扱説明書
# 誤記訂正のお知らせ

平素より弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
「Biacore T100 Ver.2 日本語取扱説明書」(カタログ番号:71-3193-31)において、記載に誤りがありました。
深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させていただきます。

| ページ | 訂正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 144 | 補足 5-40 | $k_m = 0.98 \times \sqrt{\frac{D^2 \times f}{0.3 \times h^2 \times w \times l}}$ | $k_m = 0.98 \times \sqrt[3]{\frac{D^2 \times f}{0.3 \times h^2 \times w \times l}}$ |
| 144 | 補足 5-40 | l :フローセルの高さ | l :フローセルの長さ |
| 155 | 画面説明部分 | flow_rate　解析時のキーワードとして利用。Flow rate と同一値を入力する。 | Dilution　サンプルの希釈倍率 |
| 156 | 画面説明部分 | flow_rate　"0"と入力。 | Dilution　未入力 |
| 158 | 画面説明部分 | flow_rate　解析時のキーワードとして利用。Flow rate と同一値を入力する。 | なし |
| 158 | 表示画面 3 列目 Dilution 値 | 16000 | 1600 |
| 158 | 表示画面 4 列目 Dilution 値 | 16000 | 1600 |

※上記 155、156、158 ページの訂正により、表示画面について以下のとおり訂正させていただきます。

■155 ページ掲載

誤) flow_rate → 正) Dilution

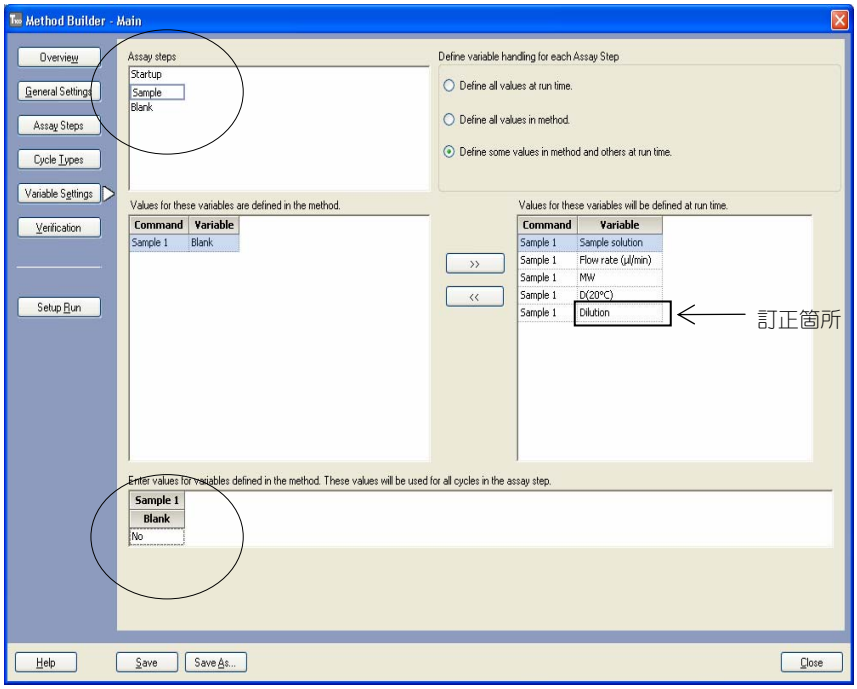


GE imagination at work

GE ヘルスケア バイオサイエンス株式会社

71-3193-51

■156 ページ掲載

誤）flow_rate → 正）Dilution

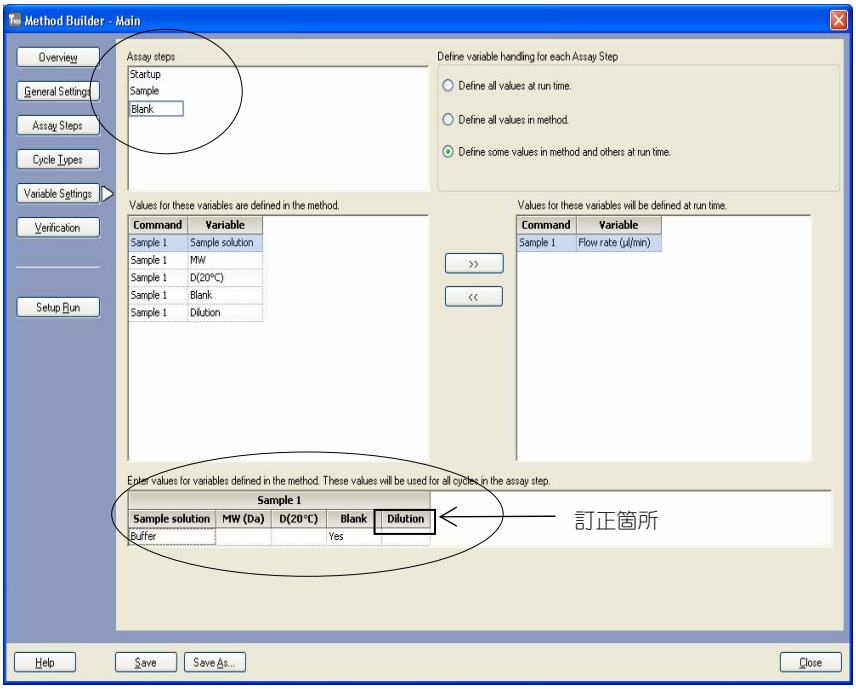


■158 ページ掲載

・flow_rate 列の表示なし

・3、4 列目 Dilution 値　　誤）16000→正）1600

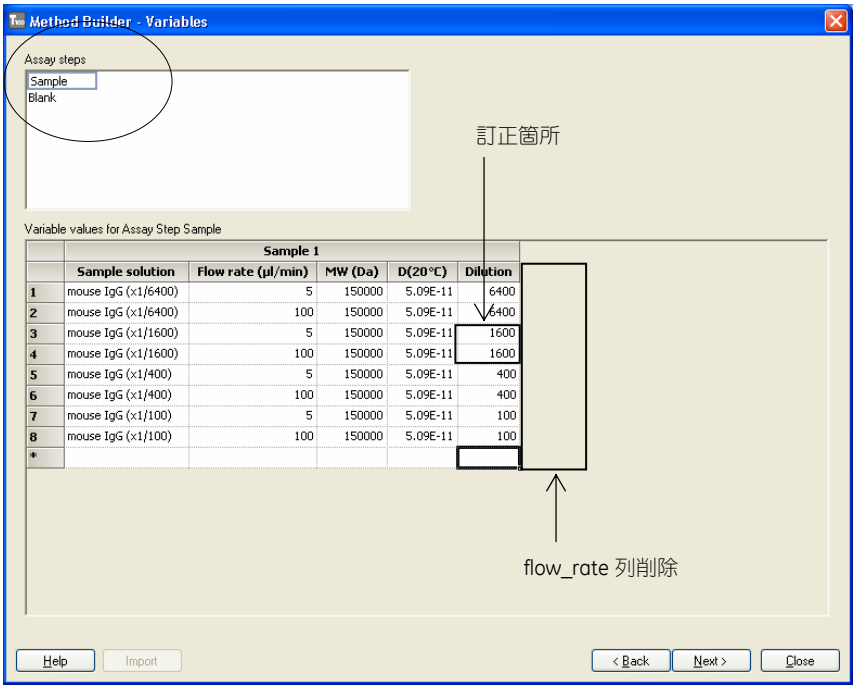
Method Builder - Variables
Assay steps
Sample
Blank
訂正箇所
Variable values for Assay Step Sample
Sample 1
Sample solution
Flow rate (µl/min)
MW (Da)
D(20°C)
Dilution
1 mouse IgG (x1/6400) 5 150000 5.09E-11 6400
2 mouse IgG (x1/6400) 100 150000 5.09E-11 6400
3 mouse IgG (x1/1600) 5 150000 5.09E-11 1600
4 mouse IgG (x1/1600) 100 150000 5.09E-11 1600
5 mouse IgG (x1/400) 5 150000 5.09E-11 400
6 mouse IgG (x1/400) 100 150000 5.09E-11 400
7 mouse IgG (x1/100) 5 150000 5.09E-11 100
8 mouse IgG (x1/100) 100 150000 5.09E-11 100
flow_rate 列削除
Help
Import
< Back
Next >
Close

■159 ページ掲載

Dilution 列の表示なし